

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

Fax. +48 48 664 21 81

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

www.pcmg.pl

PCMG/P-10/2019

Grójec, dnia 30.09.2019r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego PCMG/P-10/2019 na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z wpłynięciem pytań do ww. postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw dla części nr 1 – Wieża laparoskopowa, spektrum o poniższych parametrach zapewniający tą samą funkcjonalność:

PANORAMICZNY MONITOR MEDYCZNY LCD 27" – 1 szt.
Monitor medyczny 27" LCD
Rozdzielczość 1920x1080 pixeli
Wejścia/Wyjścia umożliwiające przesył obrazu w rozdzielczości FULL HD
Mocowanie VESA 100
Menu monitora w języku polskim
KAMERA FULL HD I GŁOWICA KAMERY FULL HD – 1 zestaw
Rozdzielczość kamery w standardzie FULL HD, 1920 x 1080 pixeli
Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do podłączania źródła światła w celu wyświetlania poziomu natężenia światła na ekranie monitora
Menu sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora w formie komunikatów
Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy Sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery
Nagrywarka medyczna FULL HD archiwizująca w formacie 1920 x 1080 pixels, zdjęcia zapisywane jako pliki JPEG, nagrania video jako MPEG – 4. Możliwość wykonywania zdjęć podczas nagrywania sekwencji video.
Konsola kamery wyposażona w wyjścia cyfrowe na tylnym panelu 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x S-Video, 1 gniazdo PS/2, złącze pamięci USB 2.0
Możliwość automatycznych ustawień parametrów dla zaawansowanych technik wideochirurgicznych w zakresie 4 różnych specjalizacji zabiegowych (laparoscopia, histeroscopia, artroskopia, urologia)
Menu urządzenia wyświetlane w języku polskim na ekranie monitora
Funkcja aktywacji (uruchamianie zapisu) cyfrowego rejestratora obrazu FULL
Zoom optyczny 16 – 34 mm pozwalający na powiększanie obrazu bez utraty jakości FULL HD.
Możliwość sterylizacji Zoom Coupler w autoklawie
Możliwość mycia i dezynfekcji głowicy kamery oraz jej sterylizacji w systemie STERRAD
Na panelu przednim konsoli przycisk do sterowania min. następującymi funkcjami: balans bieli, natężenie źródła światła, nagrywanie sekwencji video, wykonanie zdjęć, aktywacja wprowadzenia danych pacjenta, wybór opcji menu.
Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą klawiatury PS/2, m.in. imienia, nazwiska, daty

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

Fax. +48 48 664 21 81

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

www.pcmg.pl

urodzenia, ID
Funkcja tworzenia i zapisów pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników obejmujących wszystkie ustawienia kamery
Funkcja zapisów filmów i zdjęć w pamięci zewnętrznej PENDRIVE bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery
Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora
Głowica kamery wyposażona w przetwornik typu 1/3"CMOS wysokiej rozdzielczości. Kamera medyczna FULL HD z panelem z przodu urządzenia do sterowania ustawieniami oraz wyjściem systemu dokumentacji medycznej (Pendrive USB lub dysk pamięci zewnętrznej USB), znajdująca się w jednym zamkniętym module z nagrywarką medyczną FULL HD oraz źródłem światła LED. W komplecie klawiatura do wprowadzania danych pacjenta do systemu archiwizacji pokryta powłoką silikonową, pendrive o pojemności min. 32 GB.
Głowica wyposażona w 2 przyciski programowalne z możliwością przypisywania wszystkich funkcji kamery do dowolnego przycisku.
Waga głowicy z kablem 210 g
OPTYKA LAPAROSKOPOWA – 1 SZT.
Optyka laparoskopowa dedykowana do pracy z torami wizyjnymi w systemie FULL HD, wyposażona w szafirowe szkło w części proksymalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr. 10mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. 330 mm – 1 szt.
Pojemnik plastikowy do przechowywania optyki – 1 szt.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt.
Żywotność diody LED 90% po 10 000 h
Źródło światła LED wyposażone w sterowanie za pomocą przycisków na panelu przednim urządzenia – kamery zintegrowanej ze źródłem światła oraz nagrywarką FULL HD w jednym urządzeniu w skali od 1 do 10 ze skokiem co 1
Prezentacja poziomu natężenia światła na ekranie monitora
Źródło światła wyświetlające komunikaty w jasny i czytelny sposób na monitorze w języku polskim
Moc źródła światła pozwalająca na pełne wykorzystanie przezierności światłowodów o śr. do 4,8 mm
Uniwersalne przyłącze do światłowodów (akceptacja końcówek światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów: STORZ, OLYMPUS, ACMI, WOLF)
Temperatura barwowa w zakresie min. 6000-6400 K
Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia ze sterownikiem kamery w celu wyświetlenia ustalonego poziomu światła na ekranie monitora
Automatyczna aktywacja źródła światła po zainstalowaniu światłowodu w gnieździe
Światłowod medyczny wykonany w technologii bez użycia kleju, zapobiegającej uszkodzeniu wiązek przy zginaniu światłowodu, niełamiwy, o średnicy 4,8 mm i długości 300 cm
Wózek Sprzętowy – 1 zestaw
Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na 2 kołach

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

Fax. +48 48 664 21 81

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

www.pcmg.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw dla części nr 2 – Morcelator, spektrum poniższych parametrach zapewniający tą samą funkcjonalność:

MORCELATOR GINEKOLOGICZNY – 1 ZESTAW
Zestaw kompletnego morcelatora do ekstrakcji narządów podczas zabiegów laparoskopii ginekologicznej. Minimalny zakres pracy morcelatora: 100-1000 obr./min.
Motor umieszczony w rękojeści z możliwością odłączenia
Montowanie motoru zatraskowo w rękojeści perforowanej dla lepszego chłodzenia motoru podczas pracy oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci nakrętki dociskowej
Otwór w osi narzędzia pozwalający na wprowadzenia narzędzi endoskopowych o śr. do 10mm, zabezpieczony 2 uszczelkami zabezpieczającymi przed utratą odmy w trakcie pracy z narzędziami
Konsola sterująca wyposażona w wyświetlacz numeryczny informujący o aktualnej prędkości obrotowej, odłączany włącznik nożny
Płaszcz zabezpieczający nóż przed nieumyślnym skaleczeniem pacjenta lub personelu medycznego
Jednostka sterująca z przyciskami na panelu przednim oraz wyświetlaczem pokazującym aktualne parametry pracy
Przyciski jednostki sterującej z opcją podświetlenia podczas aktywacji
Jednostka sterująca wyposażona w złącza do motoru oraz włącznika nożnego - minimalny moment obrotowy - 80 Ncm
Sterowanie pracy morcelatora za pomocą włącznika nożnego
Automatyczne tryby pracy i zakresy pracy: wolny - 100-400 obr./min; średni - 300-700 obr./min; szybki - 500-1000 obr./min oraz moduł pozwalający na sterowanie obrotami w zakresie 50-1000 obr./min. w sposób płynny w zależności od siły nacisku na włącznik nożny
Nóż o średnicy 15mm wraz z bezpieczną osłoną noża oraz obturatorem min. śr.15mm
Zestaw posiadający komplet uszczelk umożliwiający uruchomienie i przeprowadzenie zabiegu operacyjnego - 10 szt.
Kleszcze typu kulociąg do przyciągania morcelowanych tkanek, rozbieralne (rękojeść, tubus, wkład roboczy) –1 szt
Kosz/ pojemnik do sterylizacji –1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 3

Monitor medyczny 26"

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora medycznego 26" z osłoną na matryce, jako rozwiązanie równoważne w zaproponowanym zestawie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Sporządziła: Aleksandra Kądziela

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

Fax. +48 48 664 21 81

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

www.pcmg.pl

Pytanie 4**Sterownik kamery Full HD**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterownika kamery, głowicy i obiektywu z funkcją obrazowania w bliskiej podczerwieni o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

	Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości
1	Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS
2	Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie), obsługa łącznie do 19 funkcji
3	Klasa wodoszczelności głowicy kamery IPX7
4	Klasa wodoszczelności konsoli kamery IPX0
5	Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli)
6	Migawka automatyczna: 1/60 (1/50)–1/50 000 sekundy
7	Rozdzielczość kamery 1920x1080, progresywny skan obrazu.
8	System skanujący : w poziomie 64kHz(60kHz), w pionie: 60,02kHz(50kHz)
9	Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego (funkcje R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue)
10	Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa
11	Wbudowane programy specjalistyczne min 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, wziernik giętki, wziernikowanie macicy, laparoscopia, laser, mikroskop, standard
12	Wbudowane programy dodatkowe: - Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED - System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED - Równomierne rozświetlenie przestrzeni operowanej, szczególnie tylnych przedziałów Zmniejszenie nasycenia barwy czerwonej
13	Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) oraz jedno analogowe
14	Wyjścia cyfrowe DVI – 2szt.; S-VHS 1szt
15	Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych
16	Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzeniem.
17	Zoom cyfrowy 1,8x
18	Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery
19	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej
20	Współpraca urządzenia z głowicami wysokiej rozdzielczości typu Inline do operacji jednoportowych.
21	Waga głowica kamery - 0,5 kg
22	Waga konsoli kamery - 4,9 kg
23	Przewód głowicy kamery - długość min 3m
24	Wymiary konsoli kamery: 31,8cmszer.x10,2 cm wys. X 38,7 cm głęb.

Sporządziła: Aleksandra Kądziela

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cyfrowego rejestratora medycznego o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

	Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi
1	uchylny dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę
2	wyświetlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazu przy obrazie (PbP)
3	Możliwość wyświetlenia i ukrycia obrazu w trybie PIP za pomocą jednego przycisku
4	Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym
5	personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji
6	możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranim zdjęciom / ikonom na ekranie głównym
7	współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu SDC 3
8	lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika
9	zapis dźwięku i komentarzy głosowych
10	Możliwość sterowania głosowego rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi podłączonymi do systemu
11	Możliwość sterowania rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi poprzez pilota
12	Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych
13	Obraz: rozdzielczość: NTSC: 640 × 480 PAL: 768 × 576 ,XGA: 1024 × 768, SXGA: 1280 × 1024, High Definition 720: 1280 × 720, High Definition 1080: 1920 × 1080; Format: Bitmapa (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG)
14	Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego 1 wyjście głośników
15	Wejścia wideo: 2xS-Video, 1x sygnał kompozytowy: (NTSC) 720x480, (PAL) 720x576; 2xDVI, 2x RGBHV (przez złącza DVI-I), SXGA 1280x1024, (XGA) 1024x768, (720p) 1280x720, (1080p) 1920x1080
16	Wyjścia wideo: 1xS-Video, 1x sygnał kompozytowy, 2xDVI i 2x RGBHV (poprzez złącza DVI-I)
17	Dwa niezależne kanały wideo: możliwość jednoczesnej rejestracji sygnałów z dwóch źródeł
18	Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), płyta (CD lub DVD), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe
19	Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć
20	Możliwość ustawienia trzech trybów prędkości transmisji strumienia w streamingu
21	Możliwość nagrywania w formatach : MPEG 2 i MPEG 4 (wysoka rozdzielczość)
22	Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie
23	Moduł obsługi DICOM
24	Pilot zdalnego sterowania urządzeniami
25	Możliwość głosowego sterowania urządzeniami

Sporządziła: Aleksandra Kądziela

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

26	Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny)
27	Możliwość zapisania 500 przypadków
28	Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s,
29	Obsługa Wifi
30	Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM
31	Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego
32	Masa całkowita: 10,2kg
33	31.75cm (szer.) × 41.91cm (głęb.) × 18.42cm (wys.)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**Pytanie 6****Sterownik kamery Full HD**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania oddzielnie procesora kamery i cyfrowego rejestratora medycznego, jako rozwiązanie równoważne? Takie rozwiązanie pozwoli pracować każdej konsoli zarówno razem jak i niezależnie. Cyfrowy rejestrator medyczny posiada więcej funkcji, między innymi lista bezpieczeństwa chirurgicznego oraz profile użytkowników wraz z przypisaniem ustawień urządzeń. Dodatkowo wbudowany dysk twardy z pojemnością 1 TB z automatycznym zapisem i archiwum.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**Pytanie 7****Głowica kamery Full HD**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania głowicy kamery z 4 przyciskami dającymi możliwość przypisania 8 funkcji sterowania, Zoomem cyfrowym 1,8x, jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**Pytanie 8****Optyka laparoskopowa**

Czy Zamawiający dopuści możliwość optyki laparoskopowej umożliwiającej wizualizację z użyciem:
- Światła widzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni - Transiluminacji w bliskiej podczerwieni i wymiarach optyki: 10.00 mm ; Kąt patrzenia optyki 30 stopni, długość 33 cm, jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Pytanie 9

Źródło światła

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednego źródła światła LED z funkcją ICG (obrazowania z kontrastem zieleni indocjaninowej- obrazowania w bliskiej podczerwieni) oraz możliwością podświetlenia moczowodów za pomocą wrzecion światłowodowych wprowadzanych do cewników do szynowania moczowodów, jako rozwiązanie równoważne?



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Źródło światła

Czy Zamawiający wymaga aby źródło światła było kompatybilne ze wszystkimi światłowodami dostępnymi na rynku różnych producentów Smith & Nephew (Dyonics)/Stryker/Olympus®/ACMI®/Storz®?


Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Źródło światła

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania źródła światła LED z funkcją ICG (obrazowania z kontrastem zieleni indocjaninowej- obrazowania w bliskiej podczerwieni) oraz możliwością podświetlenia moczowodów za pomocą wrzecion światłowodowych wprowadzanych do cewników do szynowania moczowodów o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

Źródło światła LED

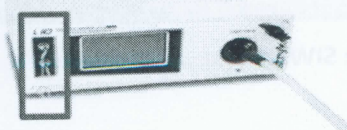

Sporządziła: Aleksandra Kąc

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl


	Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów:
1	- Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe)), - Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz - Transiluminacja w bliskiej podczerwieni .
2	Urządzenie posiada: laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm
3	Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD
4	Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta
5	Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów.
6	Tryb gotowości standby
7	Żywotność min. 60000 godzin pracy
9	Menu urządzenia w języku polskim
10	Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów
11	Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery
12	Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery.
13	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej
14	Klasa wodoszczelności źródła światła IPX0
15	Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2007, Bezpieczeństwo urządzeń laserowych
17	Urządzenie laserowe klasy 1M
18	Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5mm
19	Wymiary: 31,8 cm szer., x12,1 cm wys. X 42,7 cm głęb.
20	Waga 7,3 kg

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Źródło światła

Czy Zamawiający wymaga aby wraz ze źródłem światła były dołączone cewniki IRIS do podświetlenia moczowodów za pomocą wrzecion światłowodowych wprowadzanych do cewników do szynowania moczowodów?

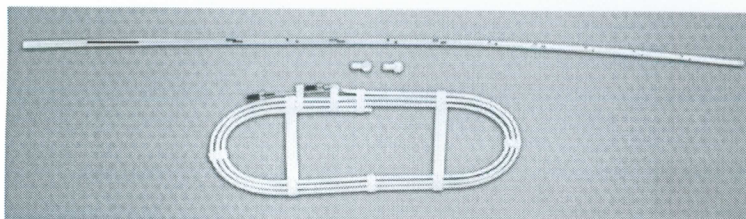

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

Fax. +48 48 664 21 81

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

www.pcmg.pl

Pytanie 13

Wózek aparaturowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wózek aparaturowy o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

	Wózek aparaturowy
1.	Wózek aparaturowy z atestem medycznym
2.	Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół
3.	Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm
4.	Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami
5.	W komplecie/ zestawie: uchwyt do światłowodu, uchwyt na głowicę kamery, możliwość montażu dodatkowe uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka, uchwyt boczny dla pompy laparoskopowej, uchwyt do CO2, wieszak na worki z płynem do irygacji, możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka, możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy,
6.	Ramię wózka umieszczone centralnie o dł. min, 700 mm
7.	Możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach
8.	Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

W związku z wystąpieniem rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ rozdziałem II „Opis przedmiotu zamówienia” część nr 1, wózek sprzętowy – 1 zestaw, a załącznikiem nr 2a do formularza oferty część nr 1 wózek sprzętowy 1 – zestaw prosimy o wyjaśnienie, który opis przedmiotu zamówienia jest poprawny.

Odpowiedź: Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ po zmianach w dniu 30.09.2019r.

Pytanie 15

W związku z wystąpieniem rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ rozdziałem II „Opis przedmiotu zamówienia” część nr 2, morcelator, a załącznikiem nr 2a do formularza oferty część nr 2 morcelator prosimy o wyjaśnienie, który opis przedmiotu zamówienia jest poprawny.

Odpowiedź: Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ po zmianach w dniu 30.09.2019r.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy dla części nr 1 i 2 do 7 dni roboczych?

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

Fax. +48 48 664 21 81

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

www.pcmg.pl

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Czy z uwagi na fakt, iż oferowany przez nas wózek aparaturowy jest wyrobem modułowym, dowolnie konfigurowalnym przez użytkownika, składającym się:

- z modułu głównego wózka, który jest wyrobem medycznym oznakowanym CE w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm) i posiada stawkę VAT 8% oraz

- z modułów wyposażenia wózka takich jak półki, szuflada, uchwyt na butlę CO2, uchwyt kamery, uchwyt stojaka, szyna sprzętowa, nieoznakowanych znakiem CE, gdyż nie podlegają one pod ustawę o wyrobach medycznych i nie są objęte deklaracją zgodności, i posiadają stawkę VAT 23%,

Zamawiający dopuści ww. wózek, który nie podlega ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązкови wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązкови oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązujących terminach:

- złożenie ofert: 03.10.2019r. godz. 10:30

- otwarcie ofert: 03.10.2019r. godz. 11:00.

Prezes Zarządu
Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu Sp. z o.o.


Joanna Czarnecka

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546